Máquina para Adelgazar

Congelación de grasa Criolipolysis

Guía de Usuario



Después de desembalar las piezas, conéctese bien y apriete.

Por favor, llenar con agua destilada antes de encender la máquina:

Pasos para el llenado de agua:

- Abrir el tornillo marcado como "Overflow".
- Conectar el embudo en "Injection".
- Llenar con aproximadamente 4 Lts de agua desmineralizada.
- La máquina estará llena cuando empiece a salir agua por “Overflow".

Contenido

Manual de funcionamiento

1.1 Estructura general
2.1 Tecnología clave
2.2 Función principal
2.3 Interfaz de usuario
3.1 Puntos de Atención
4.1 Contraindicación
4.2 Garantía
4.3 Precauciones
4.4 Datos técnicos

1.1 Estructura general

1. Criolipólisis + Vacío + Vibración + Luz Azul

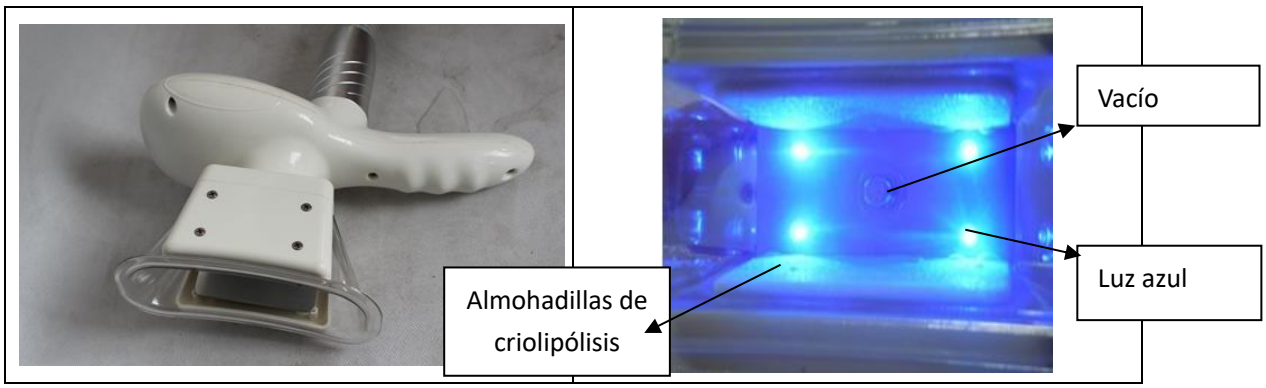

Hay 2 tamaños diferentes de mangos Cryo, uno para áreas grandes como el vientre, el otro para áreas pequeñas como el brazo o la pierna.

2.1 Tecnología clave

Congelado de vacío a -14°C / Succión de grasas

2.2 Función principal

1. Modelado corporal, disolución de grasa, repeler la celulitis.
2. Drenaje linfático, promoviendo el metabolismo y la circulación sanguínea.
3. Disminuir el exceso de agua y evitar que la grasa se acumule.
4. Estiramiento de la piel, fortalecer la elasticidad de la piel, levantamiento de la piel
5. Aclarar las arrugas del vientre, especialmente las estrías.
6. Complementando el colágeno, rejuvenecimiento de la piel.

2.3 User Interface

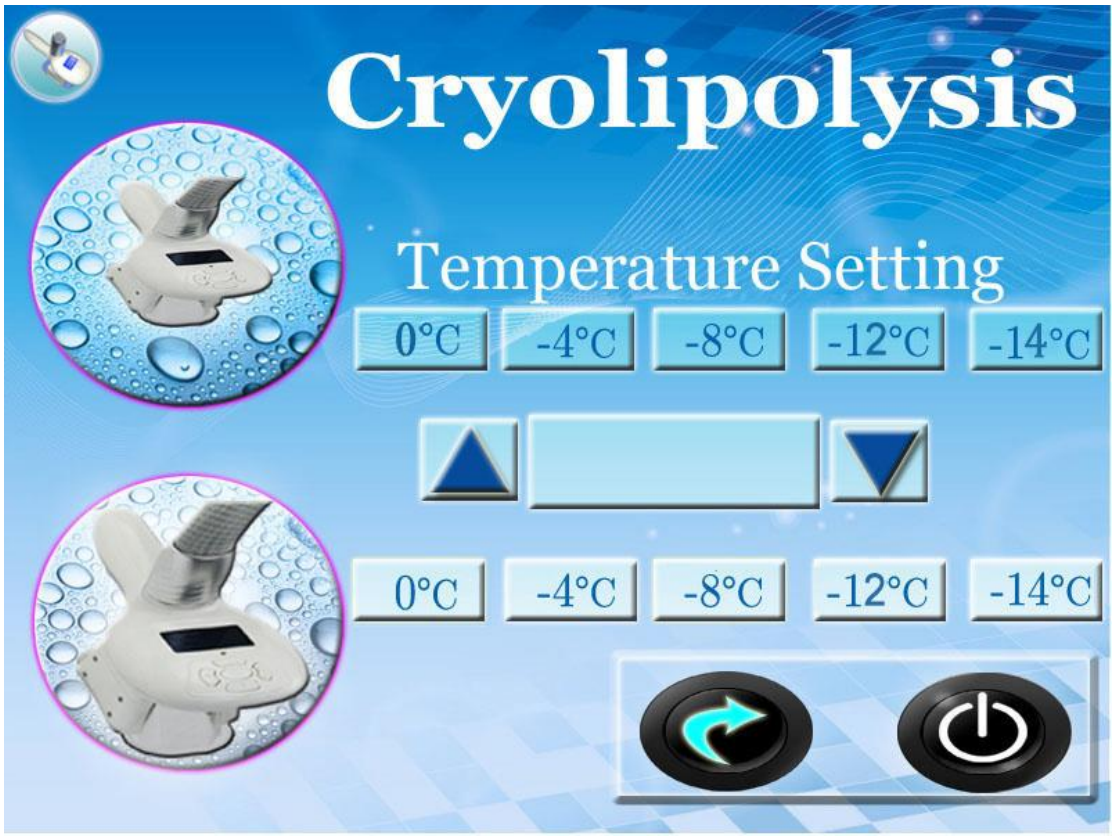

❖ **Interfaz del menú principal para Criolipólisis + vacío**

	

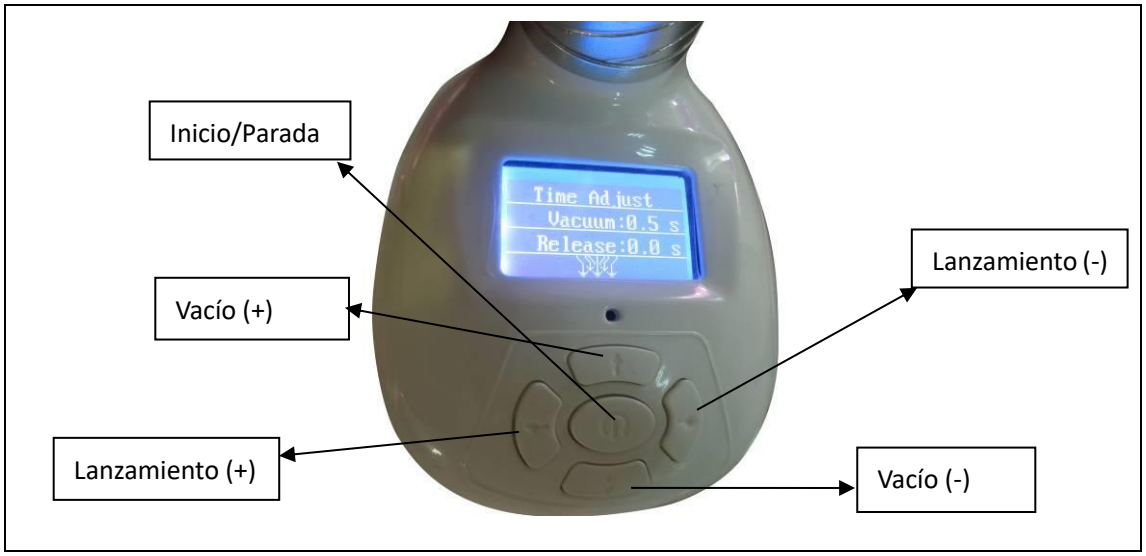

➢ Ajustes de Tratamiento de Criolipolysis

1. Por lo general, 10-30 minutos para cada parte (dependiendo del grosor de la grasa y el estado de salud. Después de 15-20 minutos de tratamiento, presione el botón de pausa para suspenderla succión, verificar y agregar líquido anticongelante.)

2. Solo puede tratar la celulitis parte por parte, por ejemplo, para eliminar la celulitis de toda la cintura, debe completar varios pasos.

3. Tome otro procedimiento de enfriamiento en la misma posición 1 o 2 meses después del primer curso, que puede reducir el grosor de la capa de grasa adicional, dos veces el tratamiento, puede mejorar el efecto de la Criolipolisis, pero no se recomienda aceptar el tratamiento repetidamente al azar.

4. El tratamiento de Criolipólisis de escultura fría está diseñado para aquellas personas físicamente sanas que tienen depósitos de grasa locales, pero no es adecuado para la persona con obesidad general. Puede apuntar a la grasa en una parte específica, como la cintura, el abdomen, la espalda, etc. El tratamiento no es una panacea, no puede tratar la obesidad. No es un sustituto de la liposucción u otros tratamientos invasivos. La pérdida de peso sustancial debe lograrse a través de una dieta equilibrada y ejercicio regular, el tratamiento de Criolipólisis que esculpe en frío solo puede eliminar la grasa extra.

5. Utilice una intensidad de succión adecuada y constante, la intensidad de succión es ajustable de acuerdo con la vulnerabilidad individual del paciente. Al mismo tiempo, se puede utilizar el modo de succión y masaje.

6. El líquido anticongelante calificado es necesario para evitar la congelación durante el proceso de tratamiento cuando la temperatura se reduce a 0 a -40 grados. [Consumibles, comprados por el usuario]
7. Después del tratamiento, puede ocurrir una lesión en la piel, congelación menor o pigmento ligera. Preste atención para cuidarse bien.

3.1 Puntos de atención

1. La máquina debe ser operada por profesionales.
2. Use líquido anticongelante.
3. El paciente no puede recibir el tratamiento si tiene el siguiente equipo médico electrónico:
   - Marcapasos cardíacos implantados u otros dispositivos electrónicos implantados.
   - Máquina de soporte vital artificial corazón-pulmón u otro equipo.
   - Dispositivo portátil de medición de ECG.
4. Los siguientes pacientes deberán contar con el consentimiento del médico profesional para utilizar la máquina.
   - Paciente con enfermedad aguda; Paciente con cáncer;
   - Paciente con enfermedades infecciosas;
   - Mujeres embarazadas.
   - Paciente con enfermedad cardíaca;
   - Pacientes con fiebre.
   - Pacientes que reciben otro tratamiento o aquellos con anomalías físicas.
5. Especial atención debe prestarse a los siguientes pacientes cuando se utiliza esta máquina:
   - Lactantes y niños pequeños;
   - Personas con discapacidad sensorial o física.

4.1 Contraindicación

Por favor, evite el tratamiento de estas personas:

1. Mujeres embarazadas o mujeres que pueden estar embarazadas.
2. Cicatrización, infección del área de tratamiento
3. Historia de la cicatrización queloide
4. Uso de medicamentos que se sabe que inducen la fotosensibilidad
5. Piel frágil
6. Pacientes sometidos al procedimiento quirúrgico sin consultar con un cirujano
7. Pacientes con tumores
8. Pacientes con enfermedad grave
9. Pacientes con presión arterial baja/alta

4.2 Garantía

1. El fabricante garantiza defectos en materiales y mano de obra por un período de 1 año a partir de la fecha de compra original.
2. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad:
   A. Daños causados por accidentes, abusos, malos usos o aplicaciones indebidas; se reparará con tarifa de reparación.
   B. Daños causados por el servicio realizado por cualquier persona que no sea técnico o calificado por el fabricante.
   C. Un producto o pieza que ha sido modificada sin ningún permiso del fabricante.

4.3 Parámetros Técnicos

1. Pantalla host: pantalla táctil a color TFT de 8"
2. Voltaje: 220V / 50Hz o 110V / 50Hz (según la marca en la máquina)
3. Potencia: >800W
4. Líquido refrigerante: agua pura
5. Vacío: 650mmHg
6. Caudal de la bomba: 60L/min
7. Presión de vacío: 0-86Kpa
8. Temperatura de congelación: 0°C, -10°C, -14°C

4.4 Accesorios de este dispositivo

Línea de alimentación	1 pcs
Soporte de mango	2 pcs
Mango de enfriamiento	2 piezas

Comentario:

Si compra un mango adicional para la barbilla, los siguientes son los pasos de operación.

Haga clic en el área del marco,5 clics

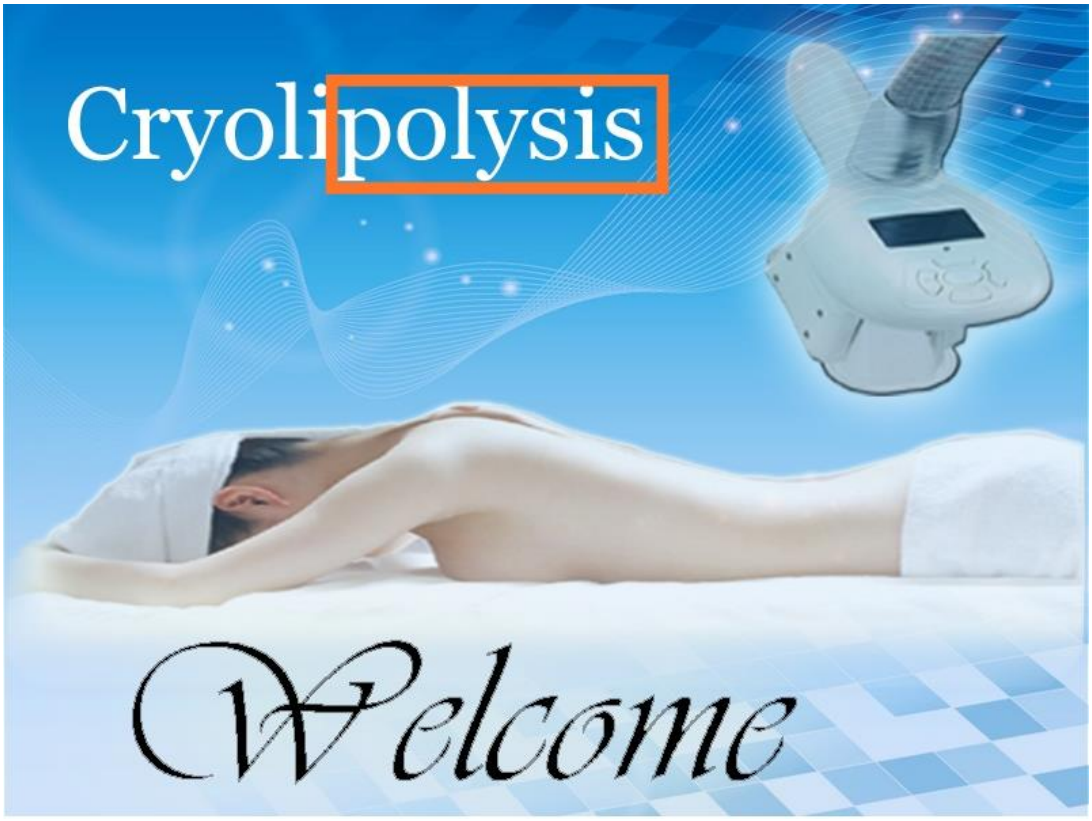

Obtendrá la pantalla del mango de la barbilla de esta manera:

