


COVID-19

Prueba Rápida de Antígeno (Prueba de Saliva)

¡Más rápido! ¡Más simple! ¡Menos invasivo!




* Las investigaciones demuestran que el virus del SARS-CoV-2 es estable en el fluido oral durante largos periodos de tiempo a temperaturas cálidas. La prueba rápida de antígenos COVID-19 (fluido oral) es una prueba de detección cualitativa de los antígenos del SARS-CoV-2 en muestras de fluido oral de individuos con sospecha de infección por SARS-CoV-2.

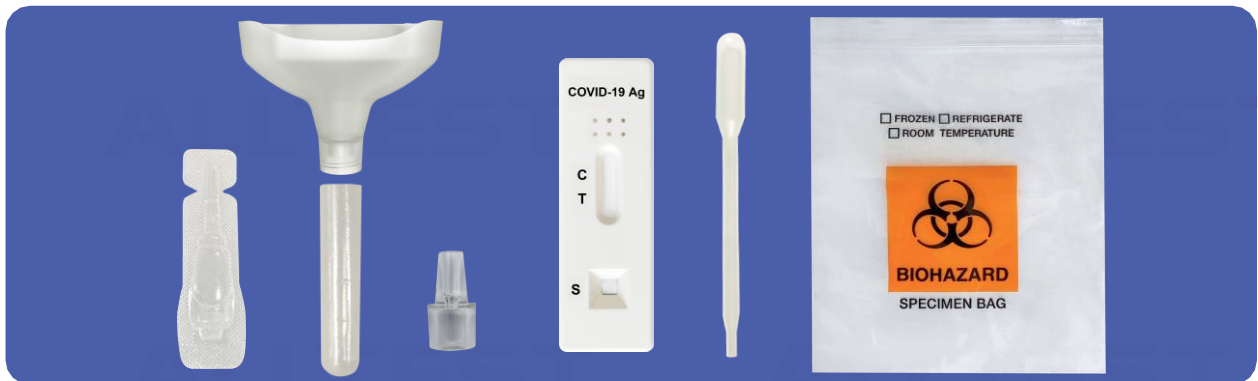

Comparación de la prueba rápida de antígeno de COVID-19 (fluido oral) y la prueba de ácido nucleico

Artículos	Prueba Rápida de Antígeno COVID-19	Real Time RT-PCR
Aplicación	Detección COVID-19	COVID-19 Detección y diagnóstico
Detección	Antígeno del SARS-CoV-2 en el fluido oral	El ácido nucleico SARS-CoV-2 en el hisopo nasofaríngeo (NP), el hisopo orofaríngeo (OP) y el esputo, etc.
Tiempo de Lectura	15 minutos	1-3 horas
Aptitud para el uso sobre el terreno/ Pequeños laboratorios	Adecuado para su uso sobre el terreno y para un entorno con pocos recursos	Complejo con técnicos capacitados y equipos de prueba altamente sensibles a la temperatura, lo que dificulta el uso en el campo.
Necesidad de un laboratorio bien equipado	Puede ser realizado por profesionales de la salud capacitados	Necesita un laboratorio bien equipado que incluya equipo de pruebas, así como un refrigerador capaz de almacenar ciertos artículos
Interpretación de los resultados	Interpretación visual simple	Resultados complejos
Ventaja en la detección	- Más rápido - Una recolección de muestras más simple - Se requiere menos entrenamiento	Mayor sensibilidad y precisión

Procedimiento

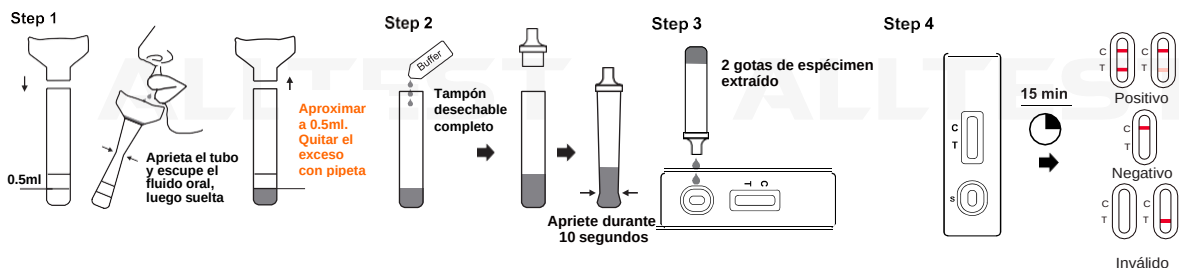

Información sobre pedidos

Referencia	Descripción	Clase	Muestra	Unidades	Marcado
ICOV-802	Prueba rápida de antígeno COVID-19	Casete	Saliva	20T	CE